



# Application mobile OneTouch Reveal®

Compatible avec les lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect® et OneTouch Select Plus Flex®

## Configuration avec Android ou iOS



**TÉLÉCHARGER**  
gratuitement l'application  
**OneTouch Reveal®**



**DÉCOUVRIR**  
l'application mobile  
**OneTouch Reveal®\***



**CONNECTER**  
le lecteur de glycémie  
**OneTouch Verio Relect®**  
à l'application  
**OneTouch Reveal®\***

# ONETOUCH®

\*Vidéos de démonstration.

Pour plus d'information, et avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation et la notice des produits.



# Aide à l'autonomie et à la gestion facilitée de votre diabète avec l'application mobile OneTouch Reveal®



## Carnet digital synchronisé

Synchronisation et organisation automatique des résultats de glycémie des lecteurs de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex®, pour une gestion simplifiée et fiable des événements de votre journée



## Suivi facile de vos progrès

Compréhension facilitée des tendances glycémiques et visualisation synthétique des résultats, couplées à l'envoi de rappels et de notifications personnalisées. L'application mobile OneTouch Reveal® vous aide, selon les recommandations de votre médecin, à cibler les actions à mettre en oeuvre.



## Partage simplifié des données avec votre équipe soignante

Partage des résultats glycémiques et de vos progrès avec votre équipe soignante (avec votre accord) visant à l'amélioration de votre prise en charge médicale\*



\* Avec votre accord et après consentement, différentes modalités pour le partage des résultats et des rapports glycémiques avec votre équipe soignante sont disponibles.



# Configuration de l'application pour un smartphone sous Android

## ETAPE 1

### Télécharger l'application mobile OneTouch Reveal®

**i** Vous avez un smartphone sous iOS ?  
Rendez-vous à la page 10 pour la configuration.

**A** Trouvez l'icône Google Play sur votre appareil Android

**B**

**C**

**D**

**E**



## ETAPE 2

# Créer un compte OneTouch Reveal® et compléter obligatoirement les informations suivantes :

**A** The first screenshot shows a list of countries: Belgique, Algeria, Argentina, Brasil, Canada, Chile, Columbia, Česká republika, Deutschland, España, France. A green callout box highlights a message at the top: "Les notifications sont désactivées. Vous pouvez les configurer dans Réglages" (Notifications are disabled. You can configure them in Settings). Below the message are two buttons: "REFUSER" and "AUTORISER".

**B** The second screenshot shows the same list of countries, but the "France" option is highlighted with a green circle.

Vous avez le choix mais, afin de profiter au maximum des avantages de l'application mobile OneTouch Reveal®, sélectionnez « Autoriser ». L'application vous enverra des notifications.

Choisir « France » comme Pays de résidence

**C** The first screenshot shows the consent screen with the title "Consentement au traitement des données personnelles/sensibles". It contains a detailed text about data processing and user rights, followed by a checkbox: "En cochant la case et en sélectionnant le bouton « J'accepte », vous confirmez que vous avez lu, compris et acceptez ces conditions et vous donnez votre consentement explicite au traitement de vos données aux fins définies".

**D** The second screenshot shows the login screen with the title "ONETOUCH Reveal". It asks if the user has an account ("Vous avez déjà un compte ? Connexion"). It includes fields for "Date de naissance", "Adresse e-mail", "Confirmer l'adresse electron.", "Mot de passe", and "Confirmer le mot de passe". Below these are checkboxes for "En créant un compte, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions d'utilisation et la Politique de protection de la vie privée et avoir accepté de recevoir des notifications de la part de LifeScan BVBA" and "Je souhaite recevoir par e-mail relatives au diabète, des supports offres promotionnelles de LifeScan". There is also a "Continuer" button and a "Maintenir la connexion" toggle switch.

Accepter le « Consentement au traitement des données personnelles/sensibles »



## ETAPE 3

# Connecter le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec l'application mobile OneTouch Reveal® par Bluetooth®

## Activer le Bluetooth du lecteur de glycémie

Sur un lecteur OneTouch Verio Reflect® :

- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Dans le menu lecteur, choisir **Réglages** puis **Bluetooth®**
- Sélectionner **Activé** et appuyer sur **OK**
- Appuyer sur le bouton retour pour retourner sur l'écran d'accueil du lecteur
- Le symbole est allumé en haut à droite de l'écran




### IMPORTANT

Veillez à ce que Bluetooth® soit activé sur le lecteur de glycémie et le smartphone

Sur un lecteur OneTouch Select Plus Flex® :


- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Appuyer sur les boutons **OK + ^**
- Le symbole est allumé en haut à droite de l'écran

## Appairer votre lecteur de glycémie

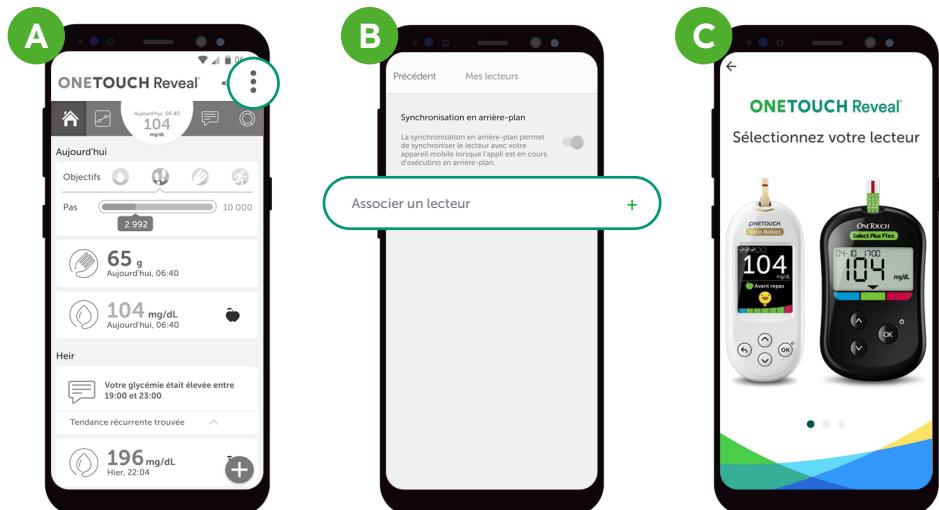



## Avec un lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®

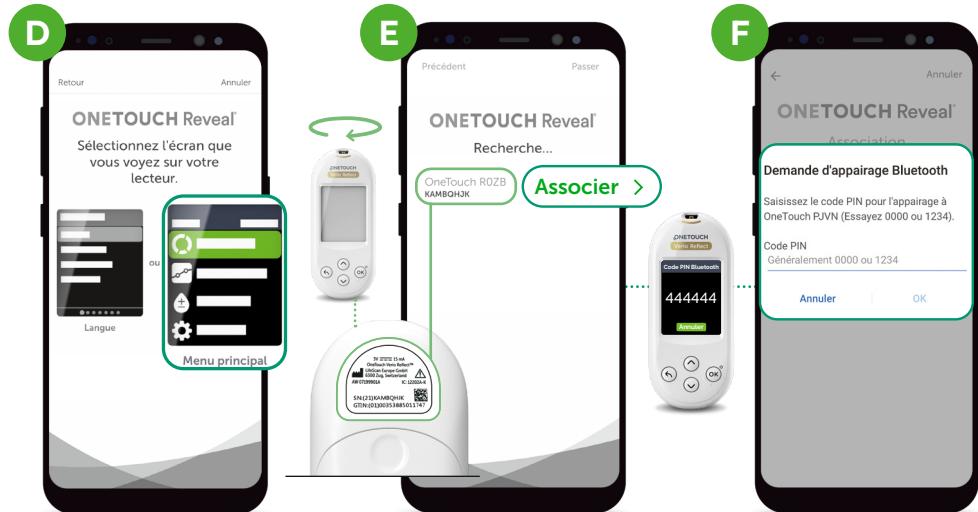

## Avec un lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®



Et vous voilà lancé !  
Vous pouvez maintenant commencer  
à synchroniser vos données.




## ETAPE 4

# Partager vos progrès avec votre professionnel de santé

### Option 1 :

Utiliser le code établissement de votre professionnel de santé pour un partage simplifié et automatique de vos données.\*

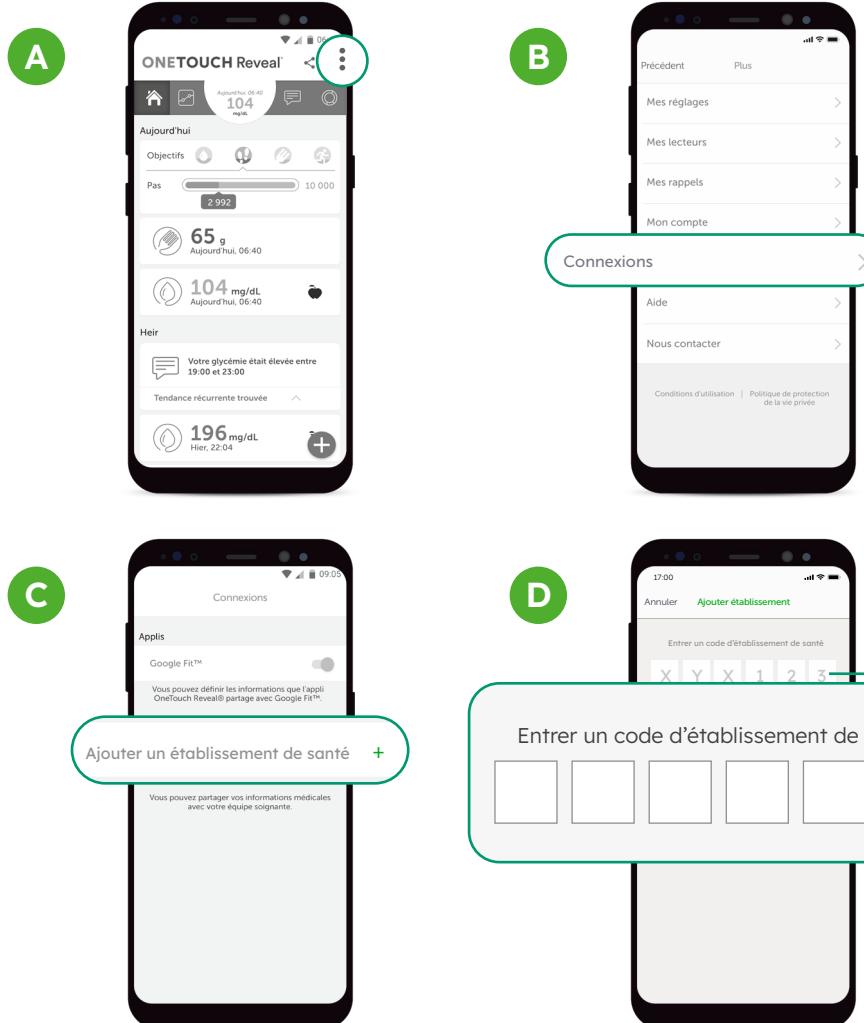

\* Le code établissement vous sera donné par votre médecin ou un membre de votre équipe soignante. Une fois renseigné dans votre application mobile OneTouch Reveal®, avec votre accord, ce code vous permettra de partager automatiquement vos données de santé avec votre équipe médicale par le biais d'une connexion cloud sécurisée. Ce partage pourra se faire après synchronisation de votre lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec votre application mobile OneTouch Reveal®.



## Option 2 :

**Imprimer le rapport de vos dernières données de santé ou partager ce rapport par e-mail.\***

**A** Screenshot of the OneTouch Reveal app home screen. A green circle highlights the share icon (three dots in a triangle) in the top right corner of the screen.

**B** Screenshot of the sharing menu. It shows options to share the last result via SMS or email, and to share a report via PDF. A green circle highlights the 'PDF' option. A larger green box highlights the 'Partager un rapport' section.

**C** Screenshot of the print menu. It shows a 'Period of reference' set to '14 days'. A large green bar covers the middle of the screen, highlighting the 'Imprimer' button at the bottom. A green circle highlights the 'Imprimer' button.

**D** Screenshot of the printed report titled 'Rapport sur mes progrès'. The report includes a summary table, a line graph titled 'Ligne de tendance des résultats', and a section for '4 Tendances les plus récentes'. A green circle highlights the play/pause icon in the top right corner of the report view.

\*\*Si vous le préférez, vous pouvez imprimer ou partager un rapport de vos dernières données de santé par e-mail. Ce rapport est généré depuis votre application mobile OneTouch Reveal® dans un format PDF. Il vous suffit alors de l'imprimer ou de l'envoyer par e-mail, à votre équipe médicale, en cliquant sur le lien de l'application mail paramétrée sur votre smartphone.



# Configuration de l'application pour un smartphone sous iOS

## ETAPE 1

### Télécharger l'application mobile OneTouch Reveal®

- i** Vous avez un smartphone sous Android ?  
Rendez-vous à la page 4 pour la configuration.

**A** Trouvez l'icône de l'App store sur votre appareil Apple

**B** A screenshot of an iPhone displaying the App Store search results for "onetouch reveal". The search bar at the top has "onetouch reveal" typed into it. Below the search bar is a list of search suggestions. At the bottom of the screen is a keyboard.

**C** A screenshot of an iPhone displaying the details page for the "OneTouch Reveal" app in the App Store. The app icon is visible at the top, followed by the app name and a star rating. Below this are three promotional cards for "SensitivSync Results", "ColorSure Technology", and "Blood Sugar Monitor". A green oval with the word "INSTALLER" is overlaid on the right side of the screen.

**D** A screenshot of an iPhone showing the "OneTouch Reveal" app icon on the home screen. The app icon features a green circle with a white "R" and the text "OneTouch Reveal" below it.

**E** A screenshot of an iPhone showing the "OneTouch Reveal" app open on the screen. The app interface displays various features and icons. A green oval with the word "OUVRIR" is overlaid on the right side of the screen.




## ETAPE 2

# Créer un compte OneTouch Reveal® et compléter obligatoirement les informations suivantes :

**A**

Vous avez le choix mais, afin de profiter au maximum des avantages de l'application mobile OneTouch Reveal®, sélectionnez « Autoriser ». L'application vous enverra des notifications.

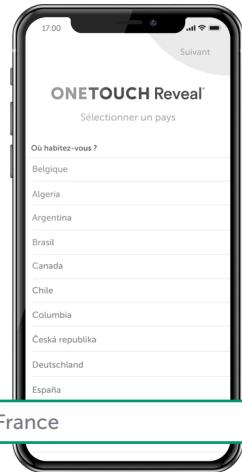**B**

Choisir « France » comme Pays de résidence

**C**

Accepter le « Consentement au traitement des données personnelles/sensibles »

**D**



## ETAPE 3

# Connecter le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec l'application mobile OneTouch Reveal® par Bluetooth®

## Activer le Bluetooth du lecteur de glycémie

Sur un lecteur OneTouch Verio Reflect® :

- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Dans le menu lecteur, choisir **Réglages** puis **Bluetooth®**
- Sélectionner **Activé** et appuyer sur **OK**
- Appuyer sur le bouton retour pour retourner sur l'écran d'accueil du lecteur
- Le symbole est allumé en haut à droite de l'écran




### IMPORTANT

Veillez à ce que Bluetooth® soit activé sur le lecteur de glycémie et le smartphone

Sur un lecteur OneTouch Select Plus Flex® :

- Allumer le lecteur avec un appui long sur **OK**
- Appuyer sur les boutons **OK + ^**
- Le symbole est allumé en haut à droite de l'écran

## Appairer votre lecteur de glycémie

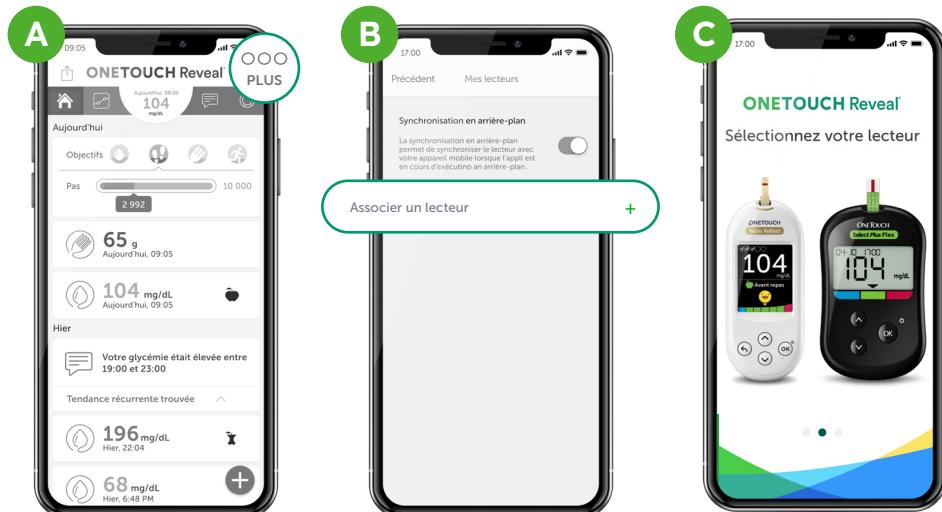



## Avec un lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect®



## Avec un lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex®



Et vous voilà lancé !  
Vous pouvez maintenant commencer  
à synchroniser vos données.



## ETAPE 4

# Partager vos progrès avec votre professionnel de santé

### Option 1 :

Utiliser le code établissement de votre professionnel de santé pour un partage simplifié et automatique de vos données.\*

**A**: Home screen of the OneTouch Reveal app showing current blood glucose levels (65 g) and steps taken (104 mg/dL). A green circle highlights the 'PLUS' button in the top right corner.

**B**: Settings menu with a green circle highlighting the 'Connexions' (Connections) option.

**C**: 'Connexions' screen showing the 'Applis' (Apps) section with 'Apple Santé' selected. A green circle highlights the '+ Ajouter un établissement de santé' (Add a healthcare institution) button.

**D**: 'Ajouter établissement' (Add institution) screen with a green circle highlighting the 'Entrer un code d'établissement de santé' (Enter an institution code) input field, which contains a placeholder 'XXXXXX 123'.

\* Le code établissement vous sera donné par votre médecin ou un membre de votre équipe soignante. Une fois renseigné dans votre application mobile OneTouch Reveal®, avec votre accord, ce code vous permettra de partager automatiquement vos données de santé avec votre équipe médicale par le biais d'une connexion cloud sécurisée. Ce partage pourra se faire après synchronisation de votre lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® ou OneTouch Select Plus Flex® avec votre application mobile OneTouch Reveal®.



## Option 2 :

**Imprimer le rapport de vos dernières données de santé ou partager ce rapport par e-mail.\***

**A**: Home screen of the OneTouch Reveal app showing current blood glucose levels (104 mg/dL), steps taken (2,992), and weight (65 g). A green circle highlights the 'Share' icon (an upward arrow) in the top right corner.

**B**: Share menu with options for 'SMS' and 'PDF'. A green circle highlights the 'PDF' option.

**C**: Print screen showing a preview of the report with a 'Print' button at the bottom. A green bar highlights the 'Print' button.

**D**: Preview of the 'Rapport sur mes progrès' (Report on my progress) showing a summary of 14 days of data, a line graph of trends, and four recent trends. A blue circle highlights the 'Share' icon (an upward arrow) in the top right corner of the report view.

\*\*Si vous le préférez, vous pouvez imprimer ou partager un rapport de vos dernières données de santé par e-mail. Ce rapport est généré depuis votre application mobile OneTouch Reveal® dans un format PDF. Il vous suffit alors de l'imprimer ou de l'envoyer par e-mail, à votre équipe médicale, en cliquant sur le lien de l'application mail paramétré sur votre smartphone.



Code d'établissement santé\*  
A renseigner ici par votre professionnel de santé :

Pour toute question sur le fonctionnement de l'application mobile  
**OneTouch Reveal® ou les lecteurs de glycémie OneTouch®**



**www.gammeOneTouch.fr**



**contact.fr@onetouch.com**



**0 800 459 459**

Service & appel  
gratuits

du lundi au vendredi de 8h à 18h

Pour plus d'information, et avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation et la notice des produits. Vous pouvez également demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien

# ONETOUCH®

\* Le code établissement permet à votre professionnel de santé d'accéder à vos données issues de l'application

10/2023. L'application OneTouch Reveal® - disponible en option - est destinée aux patients atteints de diabète, et est conçue pour recueillir et présenter les résultats des lecteurs de glycémie LifeScan. OneTouch Reveal® ne se substitue pas aux conseils des professionnels de santé. Lire attentivement la notice. Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® et les bandelettes réactives OneTouch Verio®, ainsi que le lecteur de glycémie OneTouch Select Plus Flex® et les bandelettes réactives OneTouch Select Plus®, sont des dispositifs d'AutoSurveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lire attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contacter votre professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

LifeScan Europe GmbH (Zug - Suisse)  
2310LFGSP002

LifeScan Deutschland GmbH (Düsseldorf - Allemagne)

© 2022-2023 LifeScan IP Holdings, LLC - FR-DMV-2300004 -  
Document remis par le professionnel de santé à l'utilisateur du dispositif.  
LifeScan France SAS - 23 rue François Jacob - 92500 Rueil-Malmaison - S.A.S. au capital de 11 500 001 € -  
839 988 920 R.C.S. Nanterre.

